





GC55012043, GC55012143, G0099213, G0099216

Instruction Manual for Toilet Seat

Instructions d'installation du siège de toilette

Instrucciones para la instalación de asiento para inodoro

Part / Pièces / Parte	Qty / Qté / Cant.
1. Seat / Siège / Asiento	1
2. Plastic screws / Vis en plastique / Tornillos plásticos	2
3. Metal washers / Rondelles métalliques / Huasas metalicas	2
4. Rubber pads / Coussinets en caoutchouc / Empaques	2
5. Wing nuts / Écrous papillons / Tuercas de mariposa	2

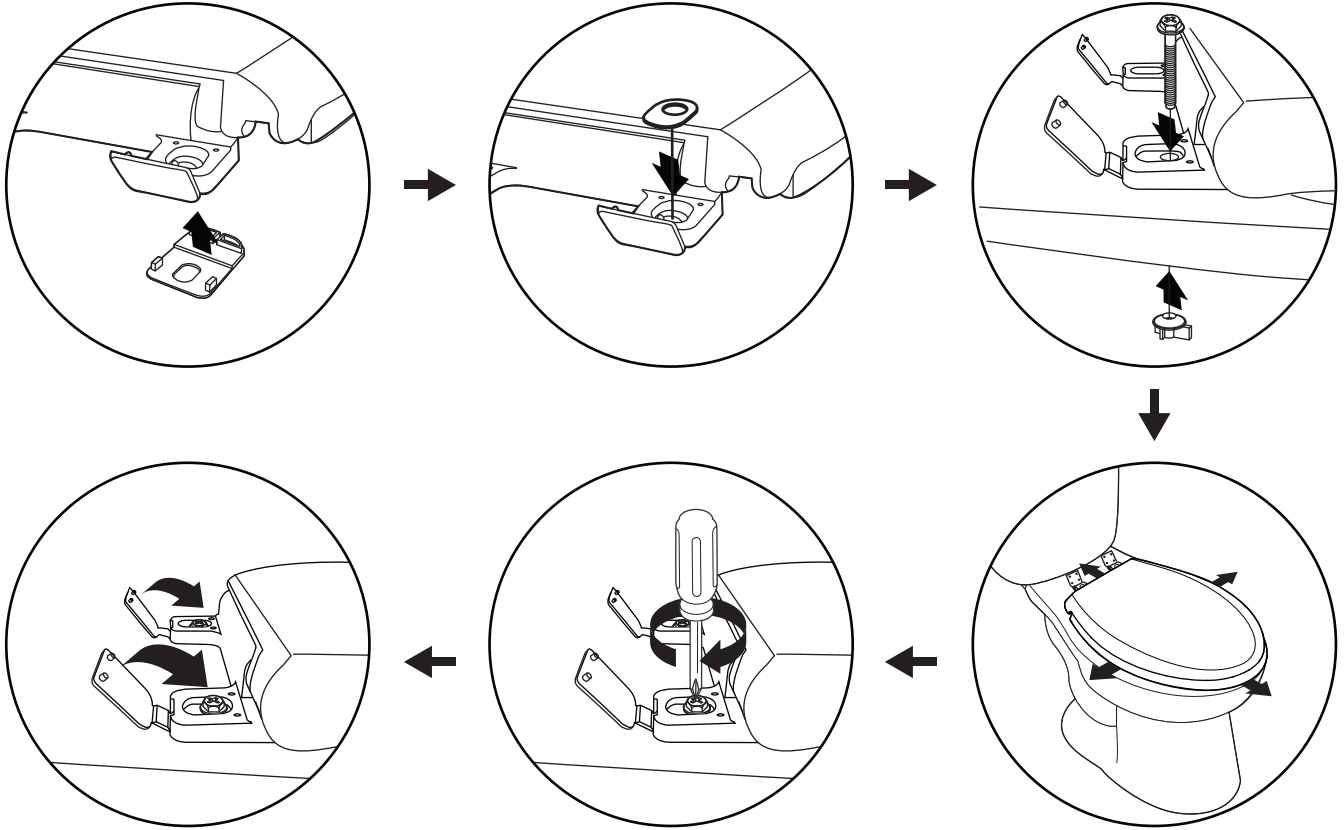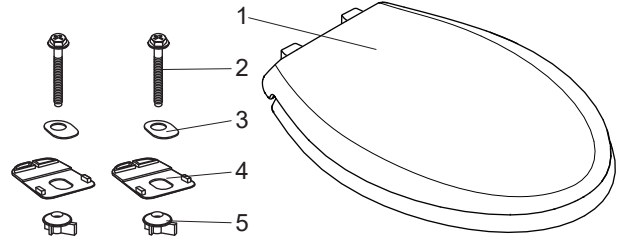

Installation Instructions

1. Attach the rubber pads (4) to the back of the hinge cover
2. Insert metal washers (3) through the hinge hole and the bowl
3. Pass the screws (2) through the hinge hole
4. Ensure seat is aligned to bowl
5. Tighten the screws (2) using the wing nuts (5)
6. Tighten top of plastic screws (2) with screw driver (philips) or socket
7. Close the hinge covers

Instructions d'installation

1. Fixez les coussinets en caoutchouc (4) à l'arrière du couvercle de la charnière
2. Insérez les rondelles métalliques (3) dans le trou de la charnière
3. Faites passer la vis (2) dans le trou de la charnière
4. Assurez-vous que le siège est aligné sur la cuvette
5. Serrez les vis (2) à l'aide des écrous papillons (5)
6. Serrez le haut des vis en plastique (2) avec un tournevis (Philips) ou douille
7. Fermez le couvercle de la charnière

Instrucciones de Instalación

1. Coloque las piezas de goma (4) en la parte trasera de la bisagra
2. Inserte las huasas metálicas (3) en el orificio de la bisagra
3. Pase el Tornillo a través del orificio de la bisagra y la taza
4. Asegúrese que el asiento está alineado con la taza
5. Apriete los tornillos (2) usando las tuerca de mariposa
6. Apriete los tornillos de plástico (2) utilizando un desarmador (estrella) o dado para ratchet
7. Cierre la tapa de la bisagra

Guarantee: This product is covered by a 1-year warranty.

Garantie: Ce produit est couvert par une garantie de 1 an.

Garantía: Este producto está cubierto por una garantía de 1 año.